

Contrôleur d'entrée pour EPA (tourniquet)**61-500-00xx - version standard****Caractéristiques techniques**

- Dimensions châssis : L 355 x P 385 x H 1050 mm
- Largeur de passage : 500 mm
- Poids : 36 kg
- Matière du châssis : acier avec peinture ESD
- Fixation : 4 tire-fonds

Caractéristiques Electriques


- Alimentation 240 V_{AC} ±10% / 50Hz

Mesures

- Temps de mesure : <2 sec
- Equipements testés : Chaussures, Blouse, Bracelet (simple ou double câblage)
- Mesure en dessous de ± 10 V_{DC}
- Electrodes indépendantes pour chaussure droite et gauche
- Plages de mesure :
 - Bracelet : 750 K Ω to 35 M Ω
 - Chaussures : 100 K Ω to 200 M Ω
- Visualisation séparée des résultats de tests : chaussure gauche, Bracelet, chaussure droite
- Indicateur visuel et sonore du sens de passage : Refusé, Gauche, Droite
- Equipements testés et plages de mesure configurables par logiciel

**Logiciel**

- Configuration du contrôleur d'entrée
- Diagnostic du matériel
- Lecture des valeurs mesurées

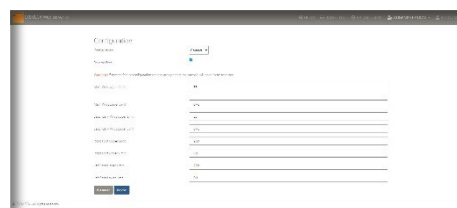**Conformités**

CE
 Directive ROHS
 Directive 2014/35/UE – Basse tension
 Directive 2014/30/UE – Compatibilité électromagnétique



Garantie : 1 an

Calibration : l'équipement est calibré à la fabrication et doit être recalibré tous les ans.



Version RFID

Le produit est similaire à la version standard en y ajoutant des fonctions qui permettent d'individualiser la gestion des accès grâce à l'identification par badge RFID et la journalisation des activités (mesures et accès).

Identification

- Lecteur RFID compatible avec la plupart des cartes HID*
- *Wiegand 26 bits par default (autres cas sur demande)

Journalisation des tests (100 000 enregistrements)

- ID de l'utilisateur
- Equipement(s) testé(s)
- Sanction du Test (OK/ Pas OK)
- Date et heure
- Affichage des mesures pour chaque équipement (bracelet, chaussures...)
- Numéro de l'équipement

Badge ID	Main Wrist	Secondary Wrist	Right Foot	Left Foot	Status	Log Time	Badge user
0000000000000000	-1	-1	-1	-1	MEASURE_OK	Jul 10, 2020, 10:04:05 AM	pass pass
0000000000000000	-1	-1	-1	-1	MEASURE_OK	Jul 10, 2020, 9:58:07 AM	pass pass
0000000000000000	1450207	1.99813	54290.3	53980.094	MEASURE_OK	Jul 8, 2020, 2:52:22 PM	fail fail
0000000000000000	1.666688	1.99813	54290.3	53980.094	MEASURE_OK	Jul 8, 2020, 3:52:08 PM	fail fail
0000000000000000	0	0	0	0	MEASURE_TIMEOUT	Jul 8, 2020, 3:51:57 PM	fail fail
0000000000000000	0	0	0	0	UNKNOWN_BADGE	Jul 8, 2020, 3:51:19 PM	fail fail

Profil Utilisateur (50 000 enregistrements)

- N° de badge RFID
- Equipement(s) à tester

Connexion Ethernet nécessaire au LAN (service ntp) permettant le chargement des profils utilisateurs le téléchargement des journaux et l'horodatage (architecture nécessaire du réseau DHCP).

Références

Contrôleur d'entrée pour EPA

61-500-0000	Système d'entrée pour EPA gauche
61-500-0001	Système d'entrée pour EPA droit
61-500-0002	Système d'entrée pour EPA RFID gauche
61-500-0003	Système d'entrée pour EPA RFID droit

Pièces détachées

61-500-0004	Carte de mesure
61-500-0005	Face avant (interface utilisateur)
84-150-3027	Platine chaussures



Option

61-500-0017	Kit de calibration
-------------	--------------------


Calibration

La calibration est effectuée avant chaque expédition.

Vues générales

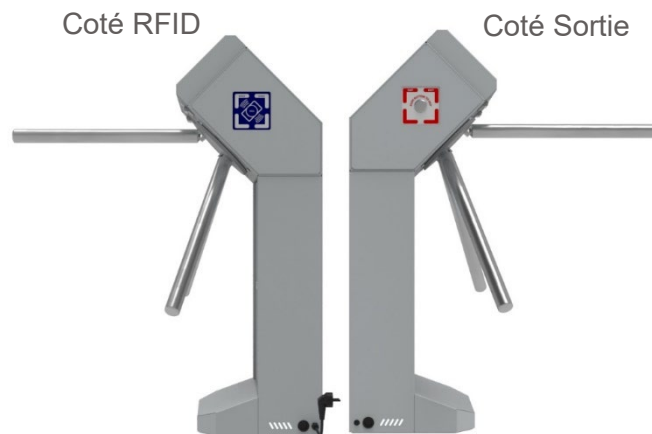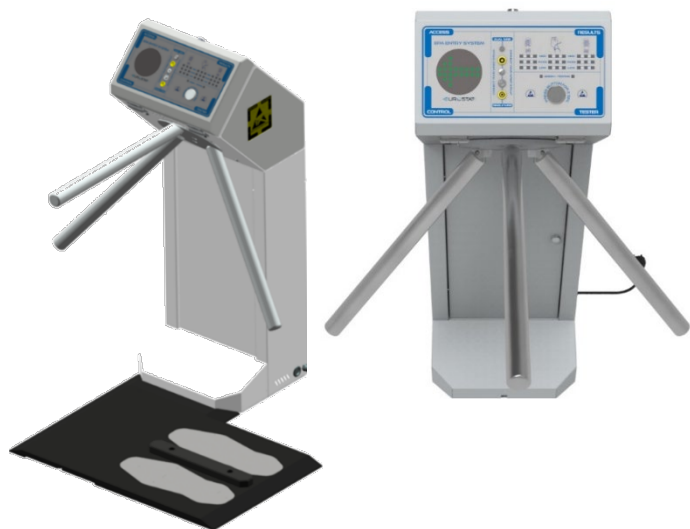

Interface utilisateur

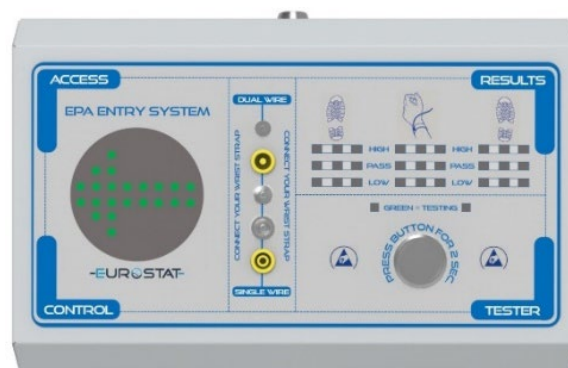

Plans d'encombrement

